

Triadyme-C

Disco artificial cervical

Puede ser candidato para una cirugía de reemplazo total de disco cervical con Triadyme®-C. Consulte con su médico para determinar si esta cirugía es adecuada para usted.



Triadyme-C está diseñado para ayudar a los pacientes con uno o más discos espinales enfermos causados por la enfermedad degenerativa discal cervical (DDD).

Este folleto está destinado a apoyar, no a sustituir, las conversaciones con su médico o equipo sanitario. Si tiene preguntas sobre este folleto, Triadyme-C o la cirugía de reemplazo total de disco cervical, hable con su médico o con otro profesional sanitario cualificado.

Cirugía de reemplazo total de disco cervical

¿Qué es la enfermedad degenerativa del disco cervical?

La enfermedad degenerativa del disco cervical ocurre cuando uno o más discos entre los huesos del cuello comienzan a desgastarse con el tiempo. Estos discos normalmente actúan como amortiguadores y permiten que el cuello se mueva con suavidad.

A medida que los discos se desgastan, las personas pueden experimentar:

- Dolor o rigidez en el cuello
- Capacidad reducida para mover el cuello
- Dolor, hormigueo, entumecimiento o debilidad que puede extenderse a los hombros, brazos o manos
- Los síntomas pueden variar de una persona a otra y pueden empeorar con el tiempo.

Síntomas comunes

Las personas con enfermedad degenerativa discal cervical pueden experimentar:

- Dolor y rigidez de cuello continuos o recurrentes
- Dolor que se extiende a los hombros, brazos o manos
- Hormigueo o entumecimiento en los brazos, manos, o dedos
- Debilidad que dificulta el agarre o los movimientos finos
- Dolores de cabeza que comienzan en el cuello y se desplazan hacia la parte posterior de la cabeza
- Dificultad para girar o inclinar la cabeza cómodamente

COLUMNA CERVICAL CON DEGENERACIÓN DISCAL




¿Qué es el reemplazo total del disco cervical?

Si le han diagnosticado una enfermedad del disco cervical sintomática (SCDD), la cirugía de reemplazo total del disco cervical (cTDR) puede ser una opción.

En este procedimiento:

- Se retira el disco dañado
- Se sustituye por un disco artificial, como el Triadyme-C
- El objetivo es mantener el movimiento natural del cuello

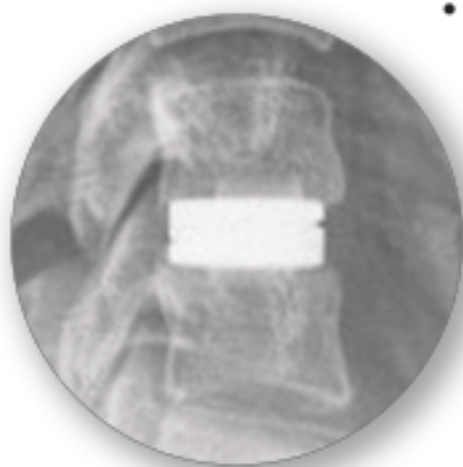

Desde hace más de 20 años, los discos artificiales se utilizan en todo el mundo como una alternativa a la fusión vertebral. A diferencia de la fusión, que detiene el movimiento en el nivel tratado, los discos artificiales están diseñados para permitir el movimiento. Mantener el movimiento puede ayudar a reducir la tensión en los discos cercanos y disminuir el riesgo de futuros problemas de columna.

Visite dymicron.com para más

Disco cervical artificial Triadyme-C

¿Qué es el disco artificial cervical Triadyme-C?

El Triadyme-C es un disco artificial compuesto por dos partes que se colocan entre dos huesos del cuello. Su forma trilobulada está diseñada para ayudar a mantener estable la columna vertebral mientras permite un movimiento natural.

Las superficies móviles están hechas de diamante policristalino Adymite™. Este material es muy fuerte y resistente al desgaste. Estas propiedades ayudan a que el disco tenga una mayor duración y continúe funcionando de manera segura con el tiempo.

¿Qué sucede durante la cirugía?

La cirugía de reemplazo total de disco cervical se realiza para tratar la enfermedad cervical discal sintomática.

Durante el procedimiento:

- Se realiza una incisión en la parte frontal del cuello
- Se retira el disco o los discos dañados
- Se coloca el Triadyme-C en la columna vertebral
- Luego se cierra la incisión

El objetivo de la cirugía es:

- Mantener el movimiento natural del cuello
- Restablecer el espacio adecuado entre los huesos del cuello
- Estabilizar la columna vertebral
- Reducir o eliminar el dolor causado por el disco dañado

Recuperación después de la cirugía


Después de la cirugía, la mayoría de los pacientes permanecen en el hospital entre uno y dos días.

Antes de salir del hospital, su médico puede proporcionarle:


- Instrucciones para el cuidado de la incisión
- Pautas de actividad
- Un calendario de seguimiento

Puede recomendarse la fisioterapia para ayudar a recuperar la fuerza y el movimiento en el cuello. Las visitas de seguimiento son importantes para supervisar la cicatrización y la recuperación.

Es importante seguir cuidadosamente las instrucciones de su médico después de la cirugía para lograr el mejor resultado posible.

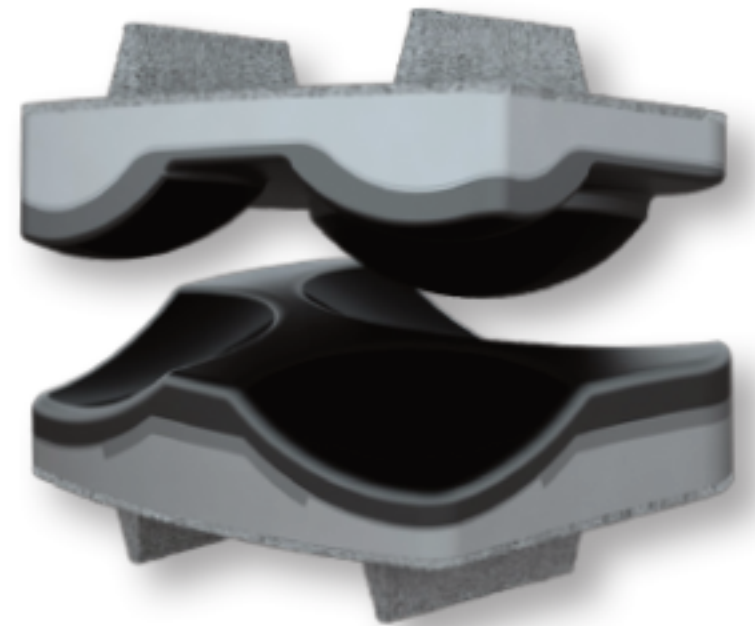

Disco cervical artificial
Triadyme-C

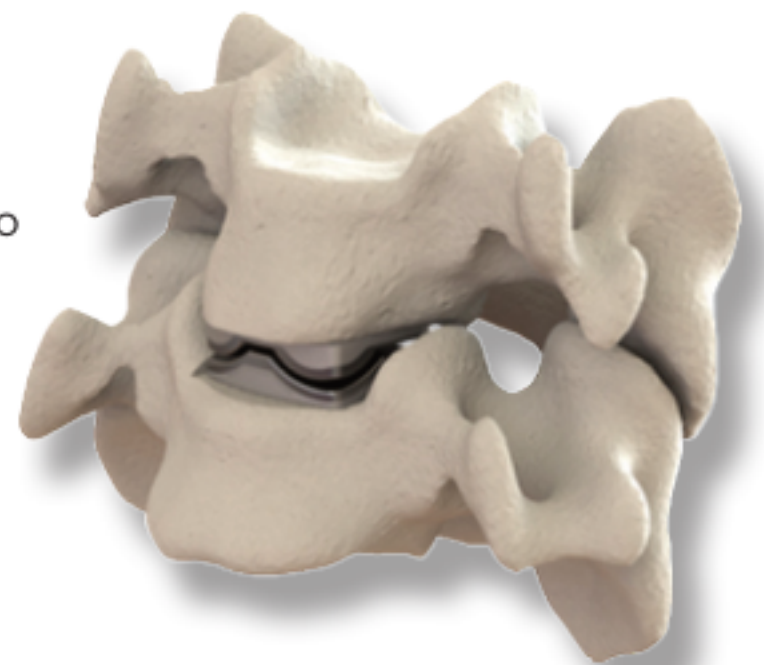

Disco artificial cervical Triadyme-C

¿Es usted candidato para una cirugía de reemplazo total de disco cervical?

Usted puede ser candidato para el reemplazo total de disco cervical si:

- Tiene más de 21 años de edad
- Le han diagnosticado una enfermedad degenerativa del disco cervical en uno o más niveles
- Sus síntomas no han mejorado con tratamientos conservadores, como reposo, fisioterapia o medicación
- Su médico le ha recomendado una cirugía de columna cervical

Si cumple estas condiciones y está interesado, su médico realizará pruebas adicionales para confirmar si Triadyme-C es adecuado para usted.

¿Quién no es candidato para una cirugía de reemplazo total de disco cervical?

Es posible que no sea elegible para esta cirugía si:

- Tiene ciertas deformidades de la columna cerca de la zona quirúrgica
- Tiene una enfermedad articular grave en el nivel afectado
- Tiene una infección activa en el lugar de la cirugía o en su cuerpo
- Tiene antecedentes de osteoporosis
- Es alérgico a los materiales utilizados en el dispositivo Triadyme-C
- Toma medicamentos que pueden interferir en la cicatrización ósea
- Está embarazada
- Su médico cree que otras condiciones de salud hacen que esta cirugía no sea segura

Solo su médico puede determinar si esta cirugía es adecuada para usted.

Posibles riesgos

Todas las cirugías implican riesgos. Su médico puede explicarle los riesgos relacionados con la cirugía de reemplazo total de disco cervical y el disco artificial Triadyme-C.

Si tiene alguna pregunta o desea más información sobre Triadyme-C o la cirugía de reemplazo total de disco cervical, póngase en contacto con su médico o su equipo en:



DYMICRON[®]



Dimicron, Inc.
1186 South 1680 W.
Orem, UT 84058 EE.UU.
Teléfono: +1.801.221.4591
www.Dymicron.com
info@Dymicron.com

Para uso exclusivo en investigación en los Estados Unidos.

SÍGUENOS: 



Representante europeo autorizado:
MT Promedt Consulting GmbH
Ernst-Heckel-Straße 7
66386 St. Ingbert,
Alemania
Teléfono: +49 6894 581020
www.mt-procons.com
info@mt-procons.com

Reemplazo total de disco cervical